Frese di preparazione

Mucotomi

In titanio gr 5.

Ø 4,5 mm

01MTCA45

Ø 6,0 mm

01MTCA60

Pallina

In acciaio chirurgico.

Ø 1,9 mm

11DS19S

Corticale

In acciaio chirurgico.

Ø 1,8 mm

05DSP18

Fresa a tacche "Unica" in acciaio per utilizzo con stop

Corta 34,5 mm | Lunga 40,5 mm

In acciaio chirurgico.

Utilizzo delle frese con stop

Gli stop vengono inseriti alla lunghezza desiderata, corrispondente a quella dell'impianto.
Le frese hanno inoltre una marcatura al laser che ne consente l'utilizzo anche senza stop.
La fresa "Unica" può essere utilizzata per tutte le famiglie di impianti Leader Italia.
Utilizzo massimo: 10 preparazioni implantari.

lunghezza
34,5 mm
40,5 mm

Ø 1,8 mm

05DSS18S
05DSS18L

Ø 2,0 mm (pilota)

05DSS20S
05DSS20L

Ø 2,3 mm

05DSS23S
05DSS23L

Ø 2,6 mm

05DSS26S
05DSS26L

34,5 mm
40,5 mm

Ø 2,8 mm

05DSS28S
05DSS28L

Ø 3,0 mm

05DSS30S
05DSS30L

Ø 3,2 mm

05DSS32S
05DSS32L

Ø 3,5 mm

05DSS35S
05DSS35L

34,5 mm
40,5 mm

Ø 3,8 mm

05DSS38S
05DSS38L

Ø 4,2 mm

05DSS42S
05DSS42L

Ø 4,5 mm

05DSS45S

Utilizzo senza stop

Ø 4,8 mm

05DSS48S
05DSS48L

Utilizzo senza stop

Stop calibrati

In acciaio chirurgico. Vengono inseriti sulla fresa per ottenere la lunghezza di lavoro desiderata.
Molto utili quando si è in prossimità di strutture anatomiche importanti: alveolare inferiore - seno mascellare.

Per frese di Ø	1,8 - 2,0 - 2,3	2,6 - 2,8 - 3,0 - 3,2	3,5 - 3,8 - 4,2
altezza			
5 mm	05STP182005	05STP263205	05STP384205
8 mm	05STP182008	05STP263208	05STP384208
10 mm	05STP182010	05STP263210	05STP384210
11,5 mm	05STP182011	05STP263211	05STP384211
13 mm	05STP182013	05STP263213	05STP384213

Kit stop calibrati

Conf. 4 pezzi: h 8-10-11,5-13 mm

Per frese di Ø	1,8 - 2,0 - 2,3	2,6 - 2,8 - 3,0 - 3,2	3,5 - 3,8 - 4,2
	05STPK1	05STPK2	05STPK3

Conf. 3 pezzi: h 5 mm per Tixos Short

Per frese di Ø	da 1,8 a 4,2
	05STPK4

Maschiatori

Per contrangolo: velocità max. 15-18 giri/min.

In titanio gr 5.

Ø 3,3 mm

01CTCAT33

Ø 3,7 mm

01CTCAT37

Ø 4,5 mm

01CTCAT45

Ø 5,0 mm

01CTCATS50

Per TiXos Short

Accessori per maschiatori

Connettori In titanio gr 5.

standard **01TCM**
corto **01TCMS**

Accessori per tutte le frese

Prolunga In acciaio.

01TEXT

Countersink

Velocità max. 250 giri/min.

In titanio gr 5.

Ø 4,0 mm

01CST40
Ø 3,75

01CSXT33
Ø 3,3 hex esterno

01CSXT40
Ø 3,75 hex esterno

Ø 5,0 mm

01CST50
Ø 4,5

Ø 6,0 mm

01CST60
Ø 5,5

Box chirurgico

Box Tixos (vuoto) **cod. 17V64**
Box Tixos Short (vuoto) **cod. 17V66**

Ideato per conservare in modo ergonomico lo strumentario chirurgico.
La serigrafia chiara agevola l'identificazione delle frese e degli strumenti accessori.

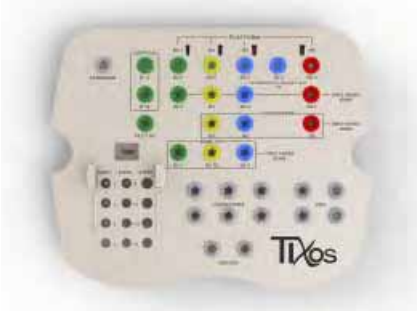

Il suo speciale design favorisce il prelevamento degli strumenti grazie all'alloggiamento in posizione verticale.
Sterilizzabile in autoclave a vapore a 134°C a 2,1 bar per 5 minuti.
Il box è predisposto per alloggiare la strumentazione necessaria all'inserimento degli impianti nei diversi diametri; può essere completato con la strumentazione desiderata (da ordinare separatamente).

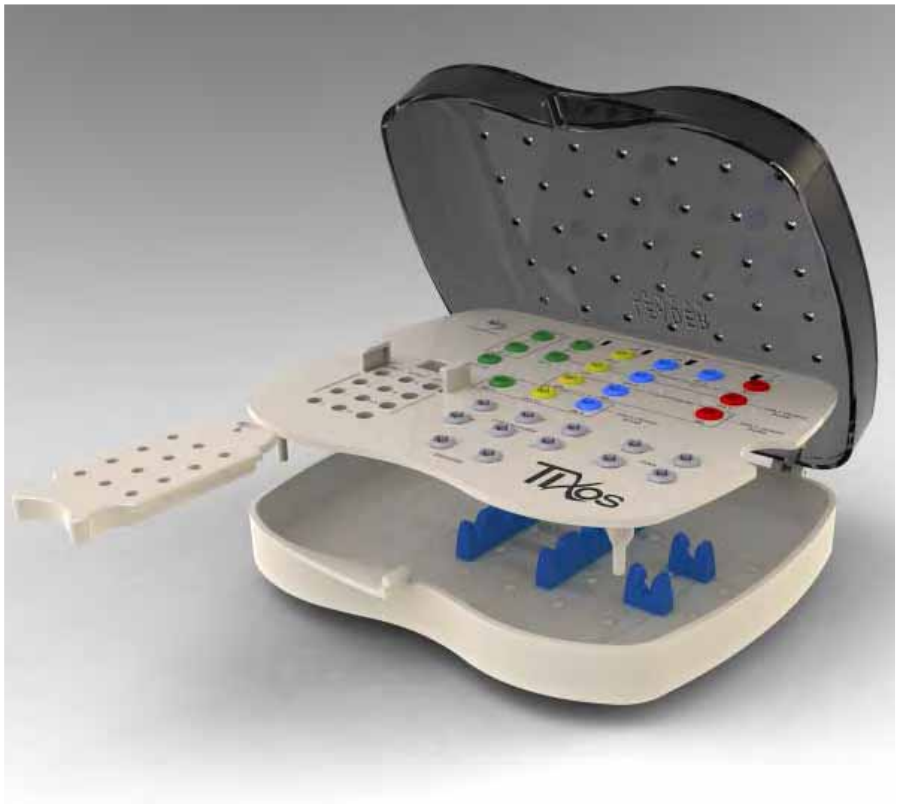

Bone expander

In titanio gr. 5, nitrurato. Altezza parte lavorante (profondità utile) 13 mm.

Tacche altezza
8,0 mm
10,0 mm
11,5 mm

Ø 2,0 mm
010BE20

Ø 2,3 mm
010BE23

Ø 2,6 mm
010BE26

Ø 2,8 mm
010BE28

Ø 3,2 mm
010BE32

Tacche altezza
8,0 mm
10,0 mm
11,5 mm

Ø 3,6 mm
010BE36

Ø 4,2 mm
010BE42

Ø 4,4 mm
010BE44

Cacciavite
01TLBE

Box (vuoto)
07V0BE

Osteotomi espansori

Con estremità convessa, si utilizzano per espandere la cresta

In titanio gr 5.

Tacche altezza
8 mm
10 mm
11 mm
13 mm
16 mm

Ø 4,0 mm
010E4008
010E4010
010E4011
010E4013
010E4016

Ø 5,0 mm
010E5008
010E5010
010E5011
010E5013
010E5016

Ø 6,0 mm
010E6008
010E6010
010E6011
010E6013
010E6016

Osteotomi compattatori

Estremità concava, si utilizzano nel mini rialzo del seno mascellare

In titanio gr 5.

altezza
8 mm
10 mm
11 mm
13 mm
16 mm

Ø 4,0 mm
010C4008
010C4010
010C4011
010C4013
010C4016

Ø 5,0 mm
010C5008
010C5010
010C5011
010C5013
010C5016

Carotatrici

Per prelievi ossei intraorali e/o per la rimozione di impianti osteointegrati

In acciaio chirurgico. Grazie ai fori laterali consentono una facile rimozione della carota ossea ottenuta.

Tacche
8-13 mm
15-18 mm

Ø 3,6/4,6 mm
11DSTB368/13
11DSTB3615/18

Ø 4,1/5,1 mm
11DSTB418/13
11DSTB4115/18

Ø 5,1/6,1 mm
11DSTB518/13
11DSTB5115/18

Ø 6,1/7,1 mm
11DSTB618/13
11DSTB6115/18

Driver universali per chirurgia e protesi

In acciaio, sezione esagonale, con testa rotante.

	ES 1,25 mm
lunghezza	
lungo 16,60 mm	01TLMR12L
corto 11,60 mm	01TLMR12S

Driver per vite passante frizionante

In acciaio, sezione esagonale.

	ES 1,60 mm
altezza	
10,56 mm	01TLM16S
	Solo per vite frizionante (PSF)

Connessioni

Inserimento manuale della fixture

Per cricchetto (per impianti)

In acciaio, sezione esagonale.

	ES 2,45 mm [1]	ES 2,45 mm frizionanti [2]
extra corta	01TW24XS	01TWF24XS
corta	01TW24S	01TWF24S
lunga	01TW24L	01TWF24L

[1] Per avvitare l'impianto.
[2] Solo per trasportare l'impianto dall'ampolla al sito chirurgico: **non utilizzare per l'inserimento dell'impianto**.

Per cricchetto dinamometrico (per viti passanti)

In acciaio, sezione esagonale.

ES 1,25 mm

01TW12L
vite cilindrica

La vite passante cilindrica va serrata a 25-30 Ncm

ES 1,6 mm

01TW16L
vite conica (PSF e PSXF)

La vite passante conica va serrata a 35 Ncm

Inserimento meccanico della fixture

Per contrangolo

In acciaio, sezione esagonale - Velocità max. 15 giri/min.

	ES 2,45 mm	ES 2,45 mm frizionanti
corta	01TLCA245S	01TLCAF245S
lunga	01TLCA245L	01TLCAF245L

All'estremità che si innesta nel contrangolo, il connettore si può torcere per valori di 90-100 Ncm; oltre i 120-130 Ncm si rompe.
L'esagono si rompe a 250 Ncm (quello frizionante si rompe a 70-80 Ncm se non viene inserito correttamente).

Per chirurgia e protesi [1]

In acciaio, sezione esagonale.

	ES 1,25 mm
corta	01TLCA125S
lunga	01TLCA125L
	vite cilindrica

ES 1,6 mm

01TLCA16L
vite conica (PSF e PSXF)

Per serrare meccanicamente la vite passante del moncone usare a basso numeri di giri: velocità max 15 giri/min.

[1] Per vite tappo, vite di guarigione e viti passanti dei monconi.

Inserimento manuale dell'impianto

Inserimento meccanico dell'impianto
Velocità contrangolo 15-18 giri/min.

Accessori

Pinzetta

01SATT

Sonda alveolare

01SAP1

L'estremità arrotondata con pallina consente l'ispezione automatica del sito ed il rispetto del seno mascellare.

Perni per parallelismo Ø 2/3,2

01PN4 In conf. da 4 pz.

01PN2 In conf. da 2 pz.

Cricchetto

01TW

Digitale manuale

01TLM

Chiavi aperte

01T45
01T50
01T60

Si utilizza con il driver Ø 1,25 per rimuovere il mount transfer, senza traumatizzare l'impianto.

Vaschetta in titanio

vuota **01SAT1**

a 2 impronte **01SAT2**

Cricchetto per newton dinamometrico registrabile

01TW1

Accessori chirurgici

Griglia in titanio

01SAT603

Ideale per sostenere una membrana nella rigenerazione ossea guidata

In titanio gr 1
Dimensioni 60x30 mm
Fori Ø 5 - Passo 1,5 mm

Viti per griglia

lunghezza
5 mm **01PN1455/5**
7 mm **01PN1457/5**
9 mm **01PN1459/5**
11 mm **01PN14511/5**
13 mm **01PN14513/5**
confez. assortita **01PN145/5**

Per fissare la griglia
In confezione da 5 pz.
In titanio gr 4
Ø 1,45 mm - Testa esagonale Ø 1,25 mm
Per inserire le viti utilizzare i driver universali 01TLM12L/S

Fresa

01DS10S

Per preparare la sede chirurgica della vite fissa griglia o fissa membrana

In acciaio
Ø 1,0 mm - Lunghezza 2,7 mm

Chiodini

lunghezza
2,7 mm **01PN2527**
3,1 mm **01PN2531**
3,5 mm **01PN2535**

Per fissare le membrane
In confezione da 5 pz.
In titanio gr 5
Ø 0,55 mm
Testa Ø 2,5 mm

Inseritore di chiodini

lunghezza
6 cm **01PNS**
9 cm **01PNL**

In titanio gr 5

Box per viti e chiodini

01V50

In alluminio autoclavabile

Fresa corticale

In acciaio chirurgico.

Ø 1,8 mm

05DSP18

Fresa a tacche "unica" in acciaio per utilizzo con stop

Corta 34,5 mm | Lunga 40,5 mm

In acciaio chirurgico.
Utilizzo delle frese con stop
Gli stop vengono inseriti alla lunghezza desiderata, corrispondente a quella dell'impianto. Le frese hanno anche una marcatura al laser che ne consente l'utilizzo anche senza stop.
La fresa "unica" può essere utilizzata per tutte le famiglie di impianti Leader Italia.
Utilizzo massimo: 10 preparazioni implantari.

lunghezza	Ø 1,8 mm	Ø 2,0 mm (pilota)	Ø 2,3 mm	Ø 2,6 mm
34,5 mm	05DSS18S	05DSS20S	05DSS23S	05DSS26S
40,5 mm	05DSS18L	05DSS20L	05DSS23L	05DSS26L

Stop calibrati

In acciaio chirurgico.
Vengono inseriti sulla fresa per ottenere la lunghezza di lavoro desiderato.
Molto utili quando si è in prossimità di strutture anatomiche importanti: alveolare inferiore - seno mascellare.

Per frese di Ø	1,8 - 2,0 - 2,3	2,6 - 2,8 - 3,0 - 3,2
altezza		
10 mm	05STP182010	05STP263210
11,5 mm	05STP182011	05STP263211
13 mm	05STP182013	05STP263213

Kit stop calibrati (conf. 4 pezzi: h 8-10-11,5-13 mm)

Per frese di Ø	1,8 - 2,0 - 2,3	2,6 - 2,8 - 3,0 - 3,2
	STPK1	STPK2

Connettori

In titanio gr 5. Sezione esagonale.

Contrangolo ES 2,5 mm

01TLCAN25

Cricchetto ES 2,5 mm

01TWN25

Prolunga per frese

In acciaio.

per tutte le frese

01TEXT

Accessori

Cricchetto

01TW

Sonda alveolare

01SAP1

L'estremità arrotondata con pallina consente l'ispezione automatica del sito ed il rispetto del seno mascellare.

Pinzetta

01SATT

Digitale manuale

01TLM

Frese di preparazione

Mucotomi In titanio gr 5.

Ø 5,0 mm

05MTCA50

Pallina In acciaio chirurgico.

Ø 1,9 mm

11DS19S

Corticale In acciaio chirurgico.

Ø 1,8 mm

05DSP18

Fresa a tacche "Unica" in acciaio per utilizzo con stop

Corta 34,5 mm | Lunga 40,5 mm

In acciaio chirurgico.

Utilizzo delle frese con stop

Gli stop vengono inseriti alla lunghezza desiderata, corrispondente a quella dell'impianto.
Le frese hanno inoltre una marcatura al laser che ne consente l'utilizzo anche senza stop.
La fresa "Unica" può essere utilizzata per tutte le famiglie di impianti Leader Italia.
Utilizzo massimo: 10 preparazioni implantari.

lunghezza
34,5 mm
40,5 mm

Ø 1,8 mm

05DSS18S
05DSS18L

Ø 2,0 mm (pilota)

05DSS20S
05DSS20L

Ø 2,6 mm

05DSS26S
05DSS26L

Ø 2,8 mm

05DSS28S
05DSS28L

34,5 mm
40,5 mm

Ø 3,0 mm

05DSS30S
05DSS30L

Ø 3,2 mm

05DSS32S
05DSS32L

Ø 3,5 mm

05DSS35S
05DSS35L

Stop calibrati

In acciaio chirurgico. Vengono inseriti sulla fresa per ottenere la lunghezza di lavoro desiderata.
Molto utili quando si è in prossimità di strutture anatomiche importanti: alveolare inferiore - seno mascellare.

Per frese di Ø	1,8 - 2,0 - 2,3	2,6 - 2,8 - 3,0 - 3,2	3,5 - 3,8 - 4,2
altezza			
10 mm	**05STP182010**	**05STP263210**	**05STP384210**
11,5 mm	**05STP182011**	**05STP263211**	**05STP384211**
13 mm	**05STP182013**	**05STP263213**	**05STP384213**

Kit stop calibrati

Conf. 4 pezzi: h 8-10-11,5-13 mm

Per frese di Ø	1,8 - 2,0 - 2,3	2,6 - 2,8 - 3,0 - 3,2	3,5 - 3,8 - 4,2
	05STPK1	**05STPK2**	**05STPK3**

Prolunga per frese

In acciaio.

Per tutte le frese

01TEXT

Maschiatori

In titanio gr 5.

Ø 3,7 mm

01CTCAT37

Ø 4,5 mm

01CTCAT45

Connettori

In acciaio. Sezione esagonale.

Corto

ES 2,5 mm

05TEXSTS

Lungo

ES 2,5 mm

05TEXSTL

Accessori

Cricchetto

01TW

Sonda alveolare

05SAP

Pinzetta

01SATT

in titanio

Digitale manuale

05TLMST2

Asta per digitale

05BTLM

per TLMST2